ULTRA Flex TST - FR16

Boucle de prélèvement conventionnelle bovine



Des prélèvements de biopsie en toute simplicité et efficacité

Avec une BOUCLE d'une grande TECHNICITÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

- **Même qualité des matériaux** qui les composent que la boucle **ULTRA**.
- Renfort en partie haute de l'épaisseur des plaquettes pour éviter toute casse prématurée.
- Chapeau tête femelle et système de fermeture équivalent pour une qualité de pose, de rotation et de tenue inégalable.
- **Marquage** LASER + JET D'ENCRE **avec taille des caractères optimisée et équivalente** au modèle **ULTRA**.

CONFORT - FACILITÉ DE POSE - MOBILITÉ - VISIBILITÉ - LISIBILITÉ - SÉCURITÉ - LONGÉVITÉ

Fût pièce mâle : taille optimisée **CONFORT - FACILITÉ DE POSE - SÉCURITÉ**

- Pour une souplesse plus forte donc un gage de meilleure survie de la boucle sur l'oreille.
- Pour un trou dans l'oreille le plus petit possible et une meilleure cicatrisation.
- Pour une facilité d'encliquetage.




Pièce mâle ULTRA Flex TST



Pièce mâle ULTRA

Support aiguille et aiguille optimisés : **FACILITÉ DE POSE - SÉCURITÉ**

- Présence d'une bague d'épaulement sur l'aiguille de biopsie, faisant office de pointeau pour accompagner au plus près l'encliquetage de la boucle et agir où les forces sont les plus importantes lors de la pose.
- Cette bague vient directement en appui sur l'insert en plastique dur noir.

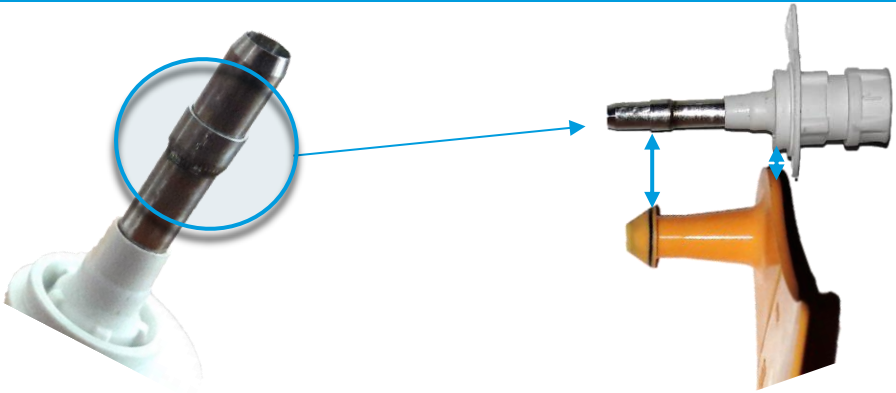

Allflex® MSD Santé Animale

ULTRA Flex TST - FR16

Boucle de prélèvement conventionnelle bovine





FABRIQUÉ EN FRANCE

Pièce femelle avec éléments complémentaires : pour un prélèvement réussi

↳ Capuchon vert permettant de faire un **appui pour un tranchage complet de la peau** de l'oreille par l'aiguille. Un morceau de ce capuchon se trouve dans l'aiguille après prélèvement, signe que ce dernier est réussi.

↳ **Chapeau blanc** pour une reconnaissance de la pièce femelle ULTRA Flex TST, et équipé à l'intérieur d'un picot pour pousser l'échantillon de biopsie dans l'aiguille afin qu'il s'y trouve coincé lors du retour de la pince en position ouverte.

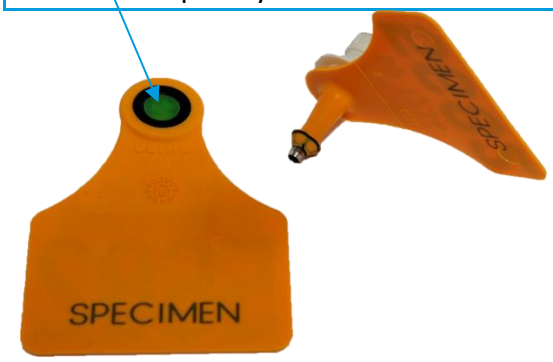

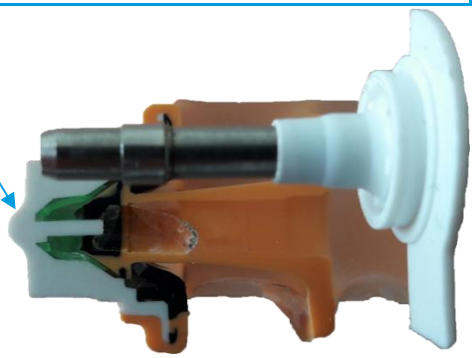





3 tubes de protection : **RÉPONDRE A TOUTES LES VALORISATIONS**





Couleurs différentes de bouchons de tube
=
FACILITÉ - SÉCURITÉ
EGD = BLEU
EGL = ROSE



Prélèvement BVD
Tube sec - EPB

Prélèvement GÉNOMIQUE
Tube avec liquide de préservation - EGL

Double prélèvement BVD et GÉNOMIQUE
Tubes sec - EGD et avec liquide - EGL

Allflex® MSD Santé Animale

ULTRA Flex TST - FR16

Boucle de prélèvement conventionnelle bovine



Marquage complet au LASER : LISIBILITÉ - TRACABILITÉ - INTEROPÉRABILITÉ

↳ Collerette de l'**aiguille** marquée au **N° national** avec ajout d'un **Datamatrix contenant N° national et N° de cheptel** => **FACILITE** la lecture automatisée des **INFORMATIONS ESSENTIELLES** pour le **laboratoire.**



↳ Tubes EPB, EGD et EGL, utilisés ensuite par les laboratoires, marqués du N° national avec ajout d'un Datamatrix avec le N° national



Pinces adaptées à chaque usage : FACILITÉ DE POSE - CONFORT




Pince TST avec adaptateur ORANGE
Code IE I05 - P0005049
Pour BVD avec tube EPB




Pince TST-V avec adaptateur BLANC
Code IE I01 - P0005061
Pour BVD et GÉNOMIQUE avec tubes EGD et EGL

Possibilité de matériel retour laboratoire associé : FACILITÉ - SÉCURITÉ - INTEROPÉRABILITÉ

↳ **Etiquette adresse laboratoire** aux normes LA POSTE -RETOUR SANTÉ, avec **N° de cheptel en chiffres et code barre**



↳ Préimpression des enveloppes RETOUR SANTÉ, nécessaire au bon acheminement des échantillons

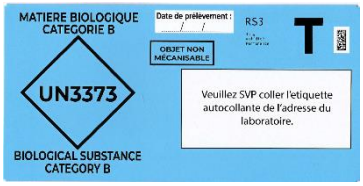

Proximité - Fiabilité :

Usines situées **en FRANCE** et **certifiées ISO 9001 et ISO 14001**, une garantie de fiabilité et de sécurité.
Un service commercial proche de vous, **REACTIF** et surtout proche de vos préoccupations

Expérience :

Nous produisons des boucles, et uniquement des boucles depuis **plus de 45 ans** à Vitré et Albi.

Pour en savoir plus :

Consulter attentivement le mémoire technique fourni dans la réponse à l'appel d'offres, il apporte des compléments techniques sur la qualité de cette boucle.